


< 可撤式装置を装着される方への注意事項 >

■ 可撤式装置の例



床矯正装置

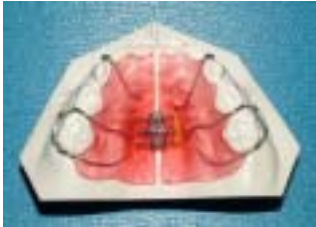

アクチベーター



リテーナー

■ 装置は、取り外しができます。

- ・ 装着直後は違和感がありますが、短期間でなれますのでご安心ください。
- ・ 装置を使う時間が短いと、治療の効果が得られなかったり、数日で口に合わなくなったりします。
- ・ 食事、歯磨き、運動のときは装置を外してください。
- ・ 指などでいじると破損の原因となります。ご家族の方も注意してあげてください。
- ・ 装置を外したときは必ずケースに入れておいてください。
- ・ 高温や、乾燥するような場所には置かないでください。
- ・ 一日一回は、歯ブラシで軽く水洗いをしてください。熱いお湯は使わないでください。装置が変形することがあります。汚れが目立つ場合は、市販の義歯洗浄剤等をお使いください。

■ 装置装着時、調節時には歯が移動し始め、2日から1週間くらい歯に違和感や痛みが出ることがあります。痛みがひどい場合にはご連絡ください。

■ ネジが入っている場合、指示通りにネジを回してください。ネジを回し忘れても、一度に多めに回したりしないでください。

■ 装置が壊れたり、粘膜にあたって痛い場合には、お早めにご連絡ください。

山口歯科医院

ホームページ <http://www.geocities.jp/yamaguchishika/>

